




COLUMNA

SILUETE

Celda de fusión intersomática
dorsal y lumbar

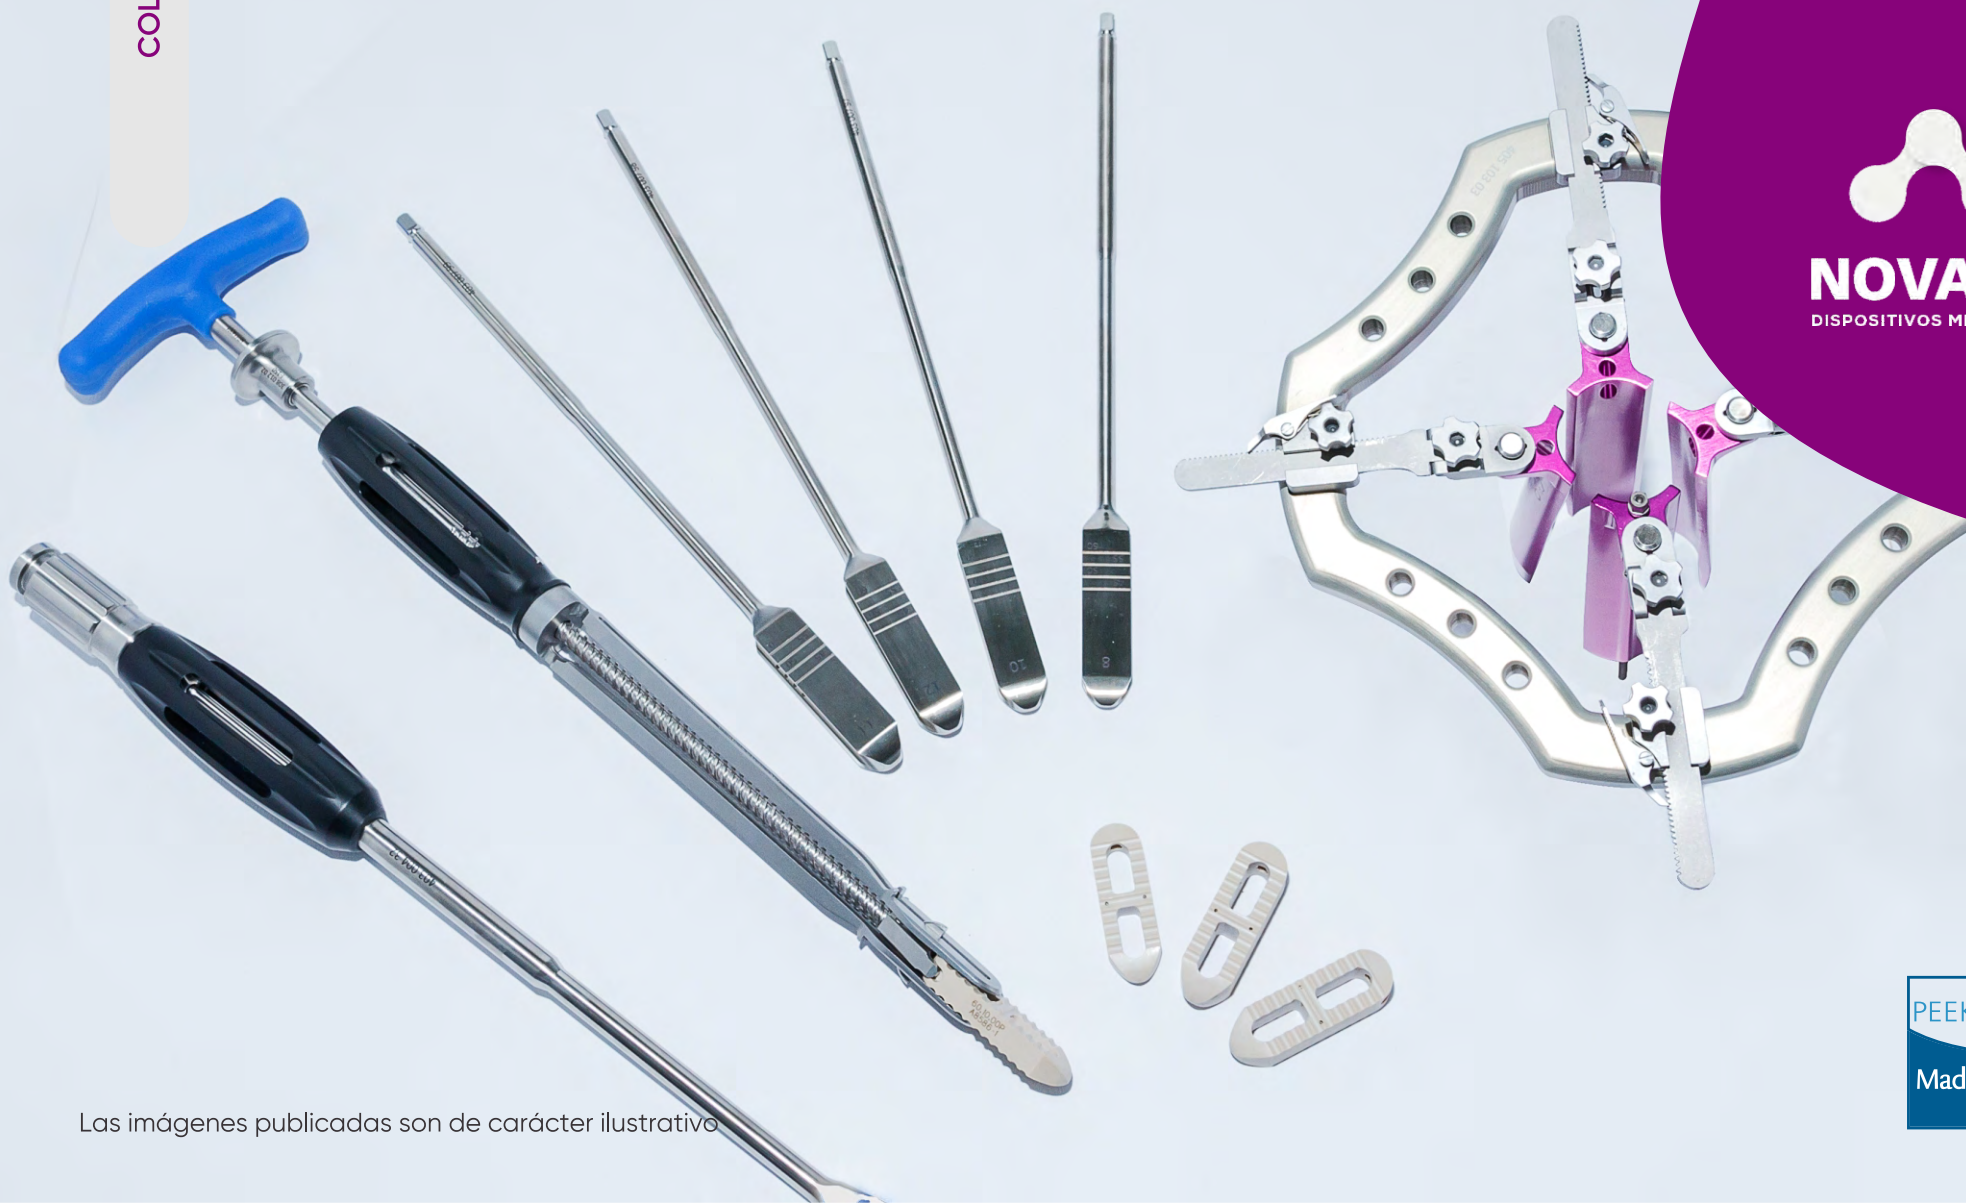

NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MÉDICOS AVANZADOS



Las imágenes publicadas son de carácter ilustrativo

Contenido



- 3 Cuadro de medidas y angulaciones
- 4 Implantes 45mm
- 5 Implantes 50mm
- 6 Implantes 55mm
- 7 Implantes 60mm
- 8 Instrumental Sistema Xlif


Cuadro de Medidas y angulaciones

		Angulación											
		0				3°				4.5°			
		Altura (mm)				Altura (mm)				Altura (mm)**			
		8	10	12	14	8	10	12	14	8	10	12	14
Longitud (mm)	45	45.08.00P	45.10.00P	45.12.00P	45.14.00P	45.08.30P	45.10.30P	45.12.30P	45.14.30P	45.08.45P	45.10.45P	45.12.45P	45.14.45P
	50	50.08.00P	50.10.00P	50.12.00P	50.14.00P	50.08.30P	50.10.30P	50.12.30P	50.14.30P	50.08.45P	50.10.45P	50.12.45P	50.14.45P
	55	55.08.00P	55.10.00P	55.12.00P	55.14.00P	55.08.30P	55.10.30P	55.12.30P	55.14.30P	55.08.45P	55.10.45P	55.12.45P	55.14.45P
	60	60.08.00P	60.10.00P	60.12.00P	60.14.00P	60.08.30P	60.10.30P	60.12.30P	60.14.30P	60.08.45P	60.10.45P	60.12.45P	60.14.45P

** La medida de angulación 4.5° no es un producto estándar del set se realiza bajo pedido.


Componentes

Celda semi luna chica plana longitud 50mm

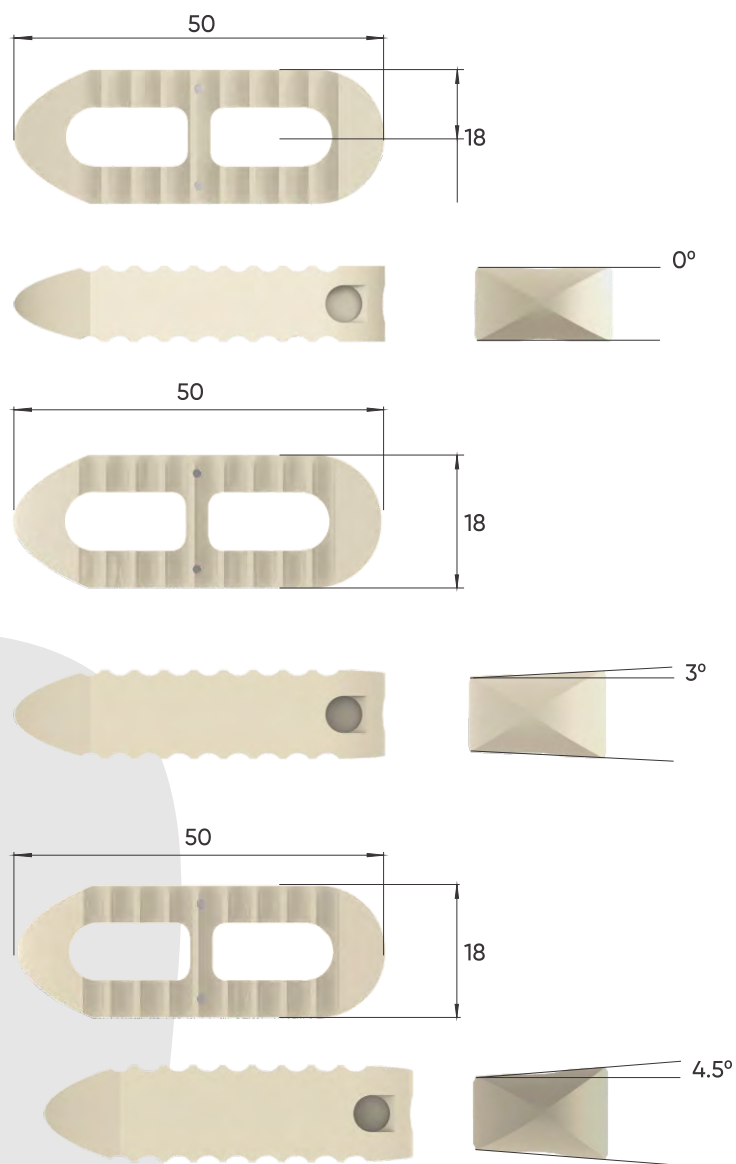




Longitud (mm)	Angulación											
	0				3°				4.5°			
	Altura (mm)				Altura (mm)				Altura (mm) **			
	8	10	12	14	8	10	12	14	8	10	12	14
50	50.08.00P	50.10.00P	50.12.00P	50.14.00P	50.08.30P	50.10.30P	50.12.30P	50.14.30P	50.08.45P	50.10.45P	50.12.45P	50.14.45P

** La medida de angulación 4.5° no es un producto estándar del set se realiza bajo pedido.

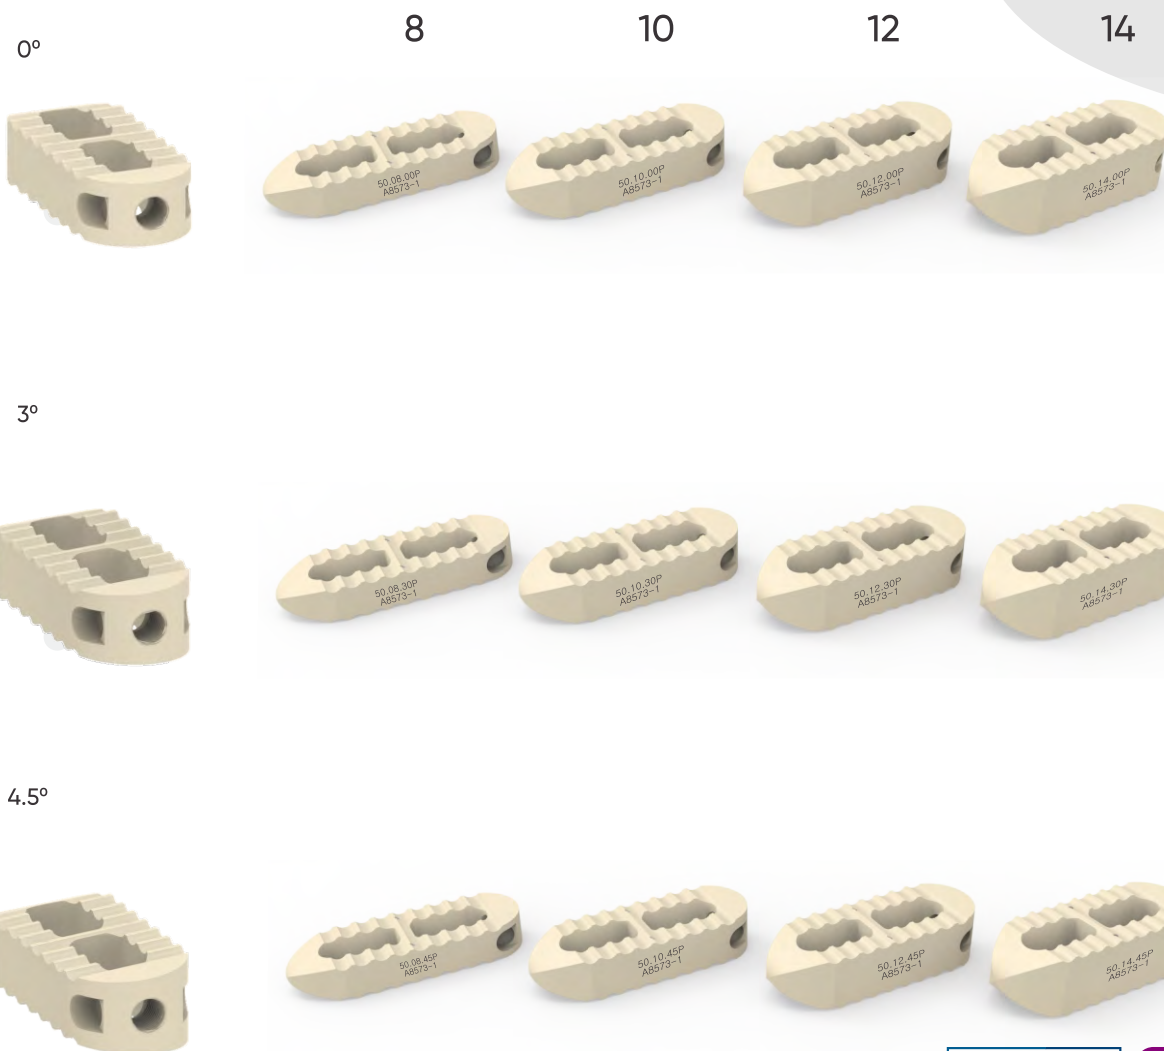

Componentes

Celda semi luna chica plana longitud 45mm

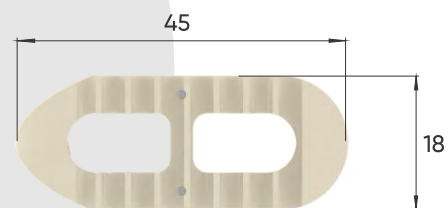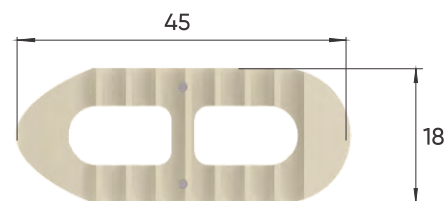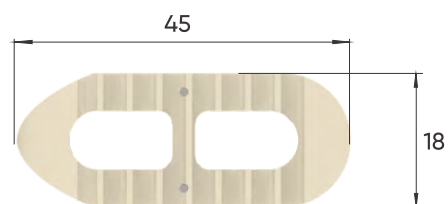

Longitud (mm)	Angulación											
	0				3°				4.5°			
	Altura (mm)				Altura (mm)				Altura (mm) **			
	8	10	12	14	8	10	12	14	8	10	12	14
45	45.08.00P	45.10.00P	45.12.00P	45.14.00P	45.08.30P	45.10.30P	45.12.30P	45.14.30P	45.08.45P	45.10.45P	45.12.45P	45.14.45P

** La medida de angulación 4.5° no es un producto estándar del set se realiza bajo pedido.


0°



8



10




12




14



3°






4.5°



Componentes

Celda semi luna chica plana longitud 55mm

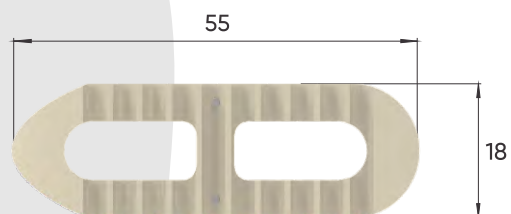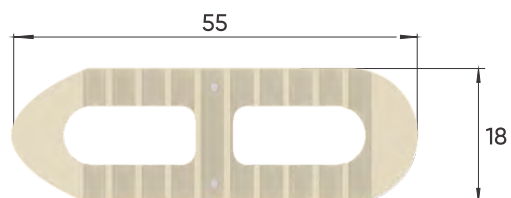

Longitud (mm)	Angulación											
	0				3°				4.5°			
	Altura (mm)				Altura (mm)				Altura (mm) **			
	8	10	12	14	8	10	12	14	8	10	12	14
55	55.08.00P	55.10.00P	55.12.00P	55.14.00P	55.08.30P	55.10.30P	55.12.30P	55.14.30P	55.08.45P	55.10.45P	55.12.45P	55.14.45P

** La medida de angulación 4.5° no es un producto estándar del set se realiza bajo pedido.


0°




8




10



12





14



3°







4.5°



Componentes

Celda semi luna chica plana longitud 60mm

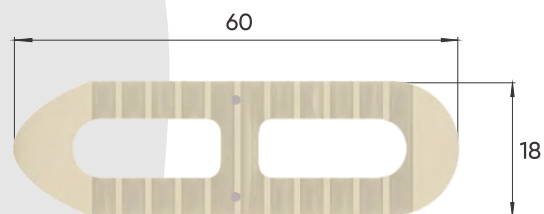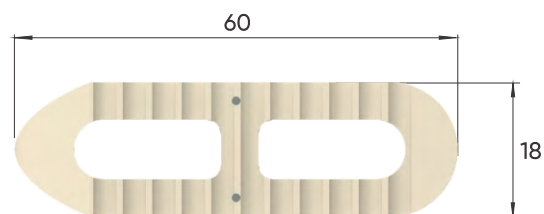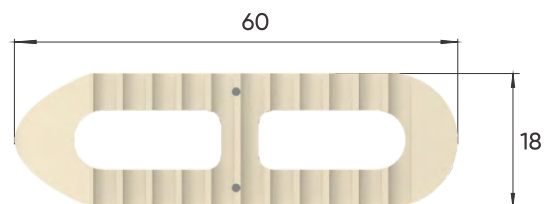

Longitud (mm)	Angulación											
	0				3°				4.5°			
	Altura (mm)				Altura (mm)				Altura (mm)			
	8	10	12	14	8	10	12	14	8	10	12	14
60	60.08.00P	60.10.00P	60.12.00P	60.14.00P	60.08.30P	60.10.30P	60.12.30P	60.14.30P	60.08.45P	60.10.45P	60.12.45P	60.14.45P


0°



8



10



12



14



3°



4.5°



Instrumental

Celda de fusión intersomática
dorsal y lumbar



NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MÉDICOS AVANZADOS

Componentes



Martillo deslizante
403 020 24



Mango Largo
403 009 08



Raspa Xlif
403 005 19



Impactor sólido
403 020 23



Distractor Insertor
403 022 16



Impactor/Introducción Xlif
403 004 32

Componentes



Mazo
403 157 00



Insertor paleta (2 unidades)
403 121 01



Extractor de valva
403 081 08



Brazo porta valva (2 unidades)
403 117 05
Valva lateral (2 unidades)
403 105 56

El sistema **XLIF** requiere realizar discectomía previa a la colocación del implante

Contamos con sets de:

- Distractores Raspadores
- Pinzas Pituitarias y Kerrison
- Distractores Curetas y legtras

consulte a nuestros asesores para más información

Componentes



Contenedor de Implantes Xlif 45mm

403 002 67

Contenedor de Implantes Xlif 45mm (4.5°)**

403 002 74



Contenedor de Implantes Xlif 50mm

403 002 68

Contenedor de Implantes Xlif 50mm (4.5°)**

403 002 75



Contenedor de Implantes Xlif 55mm

403 002 69

Contenedor de Implantes Xlif 55mm (4.5°)**

403 002 76



Contenedor de Implantes Xlif 60mm

403 002 70

Contenedor de Implantes Xlif 60mm (4.5°)**

403 002 77

** La medida de angulación 4.5° no es un producto estándar del set se realiza bajo pedido.

Componentes



Probador XLIF 8mm
403 007 96



Probador XLIF 10mm
403 007 97



Probador XLIF 12mm
403 007 98



Probador XLIF 14mm
403 007 99



Escariador 70x18x14
403 147 03



Escariador 70x18x12
403 147 02



Escariador 70x18x10
403 147 01



Escariador 70x18x8
403 147 00


Componentes

Bandeja de instrumental **403 003 30**


Bandeja de instrumental Escariadores **403 003 42**

Bandeja de instrumental Tornilleras **403 003 43**

Tapa metálica **403 400 00**

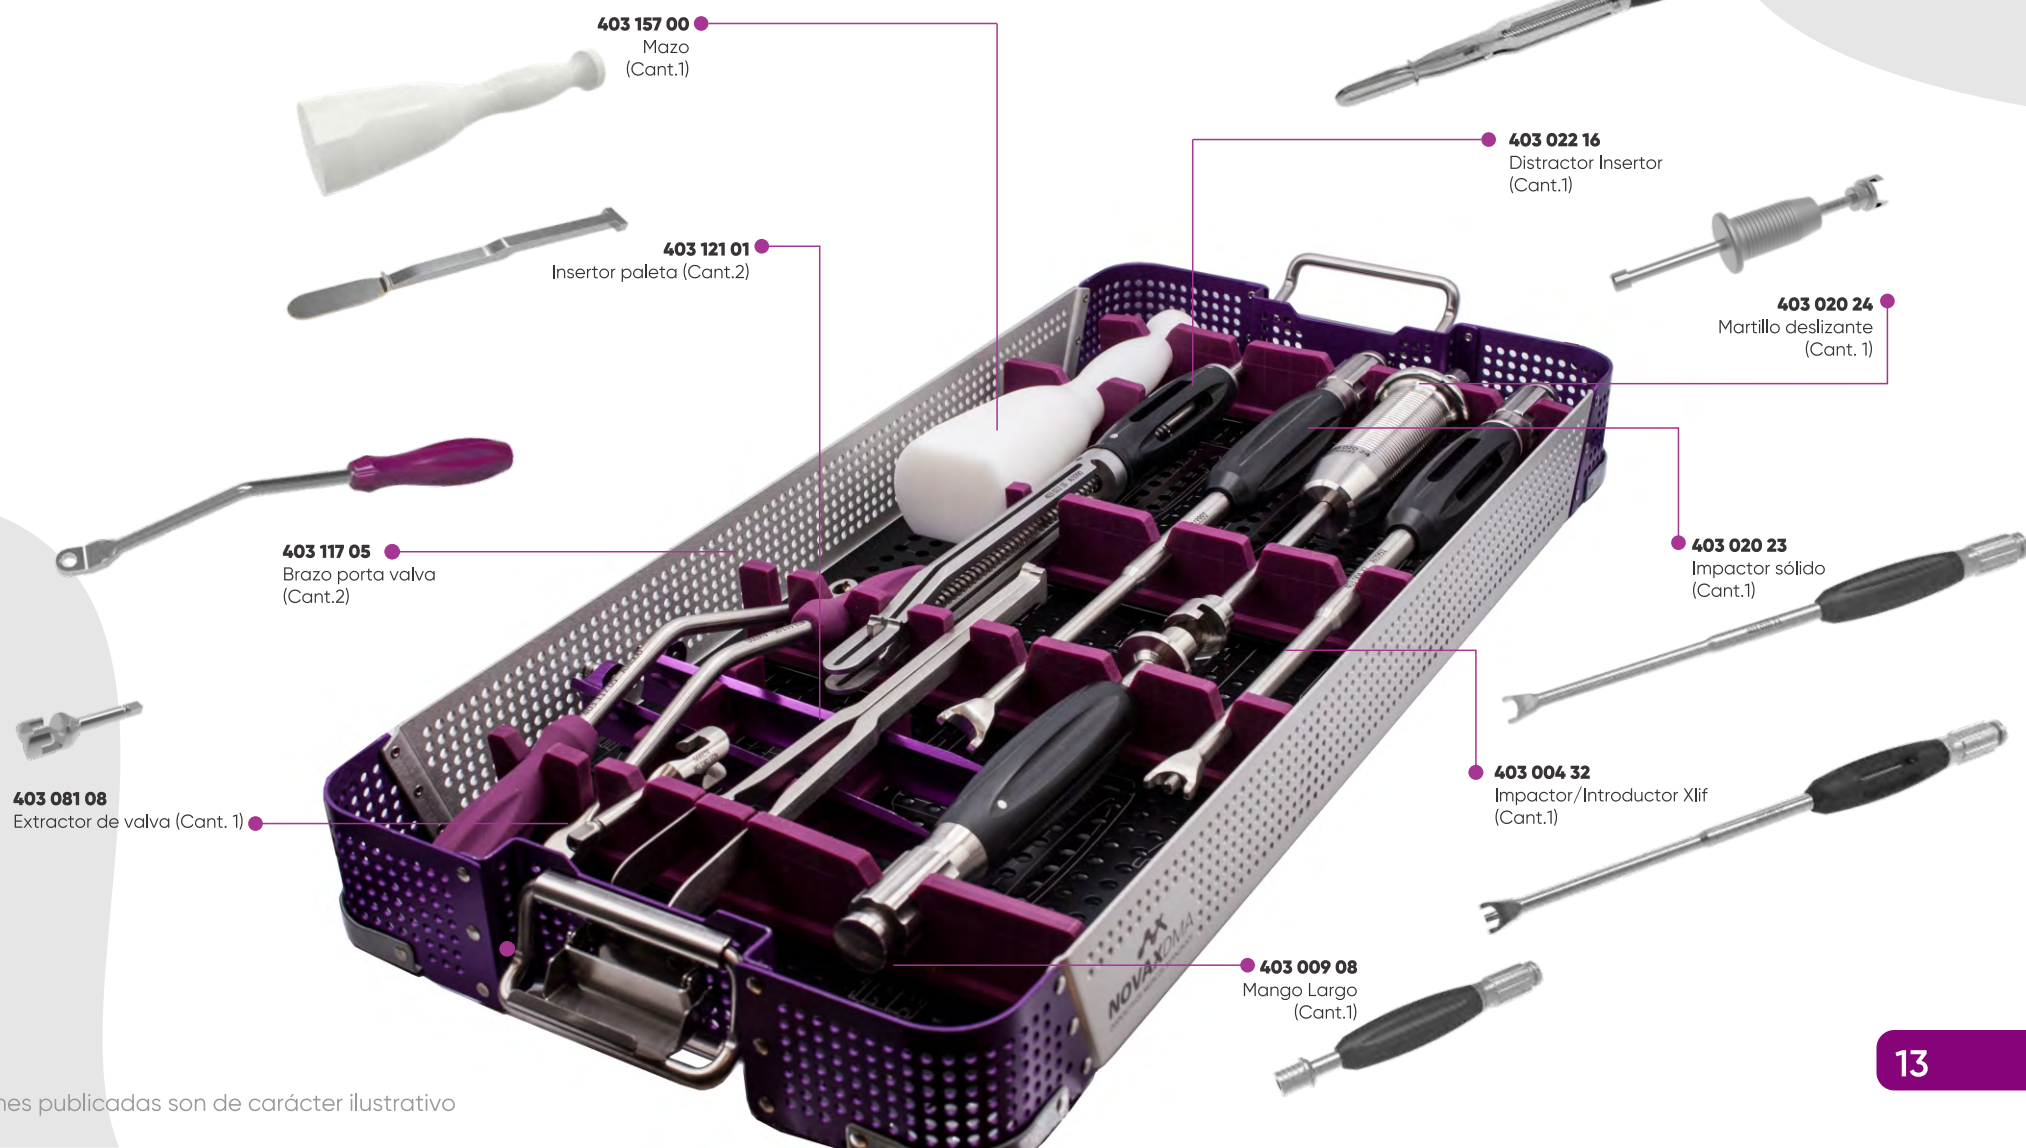

Conjuntos completos con instrumental accesorio

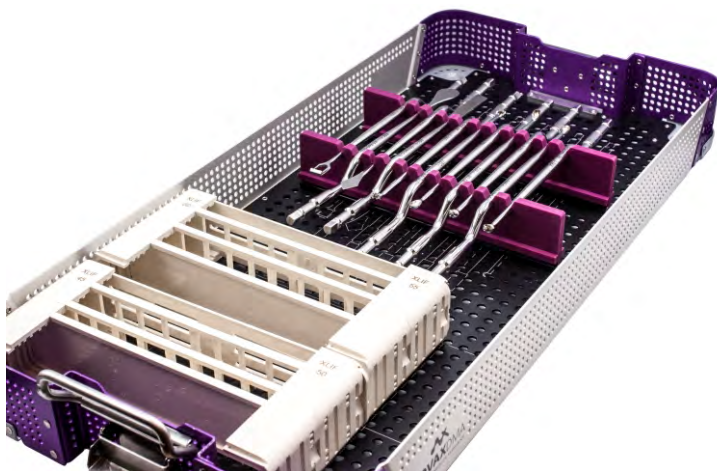

Sets de discectomía



Sets de pinzas

El sistema **XLIF** requiere realizar discectomía previa a la colocación del implante

Contamos con sets de:


- Distractores Raspadores
- Pinzas Pituitarias y Kerrison
- Distractores Curetas y legras

consulte a nuestros asesores para más información



Sets de raspadores

Instrumental

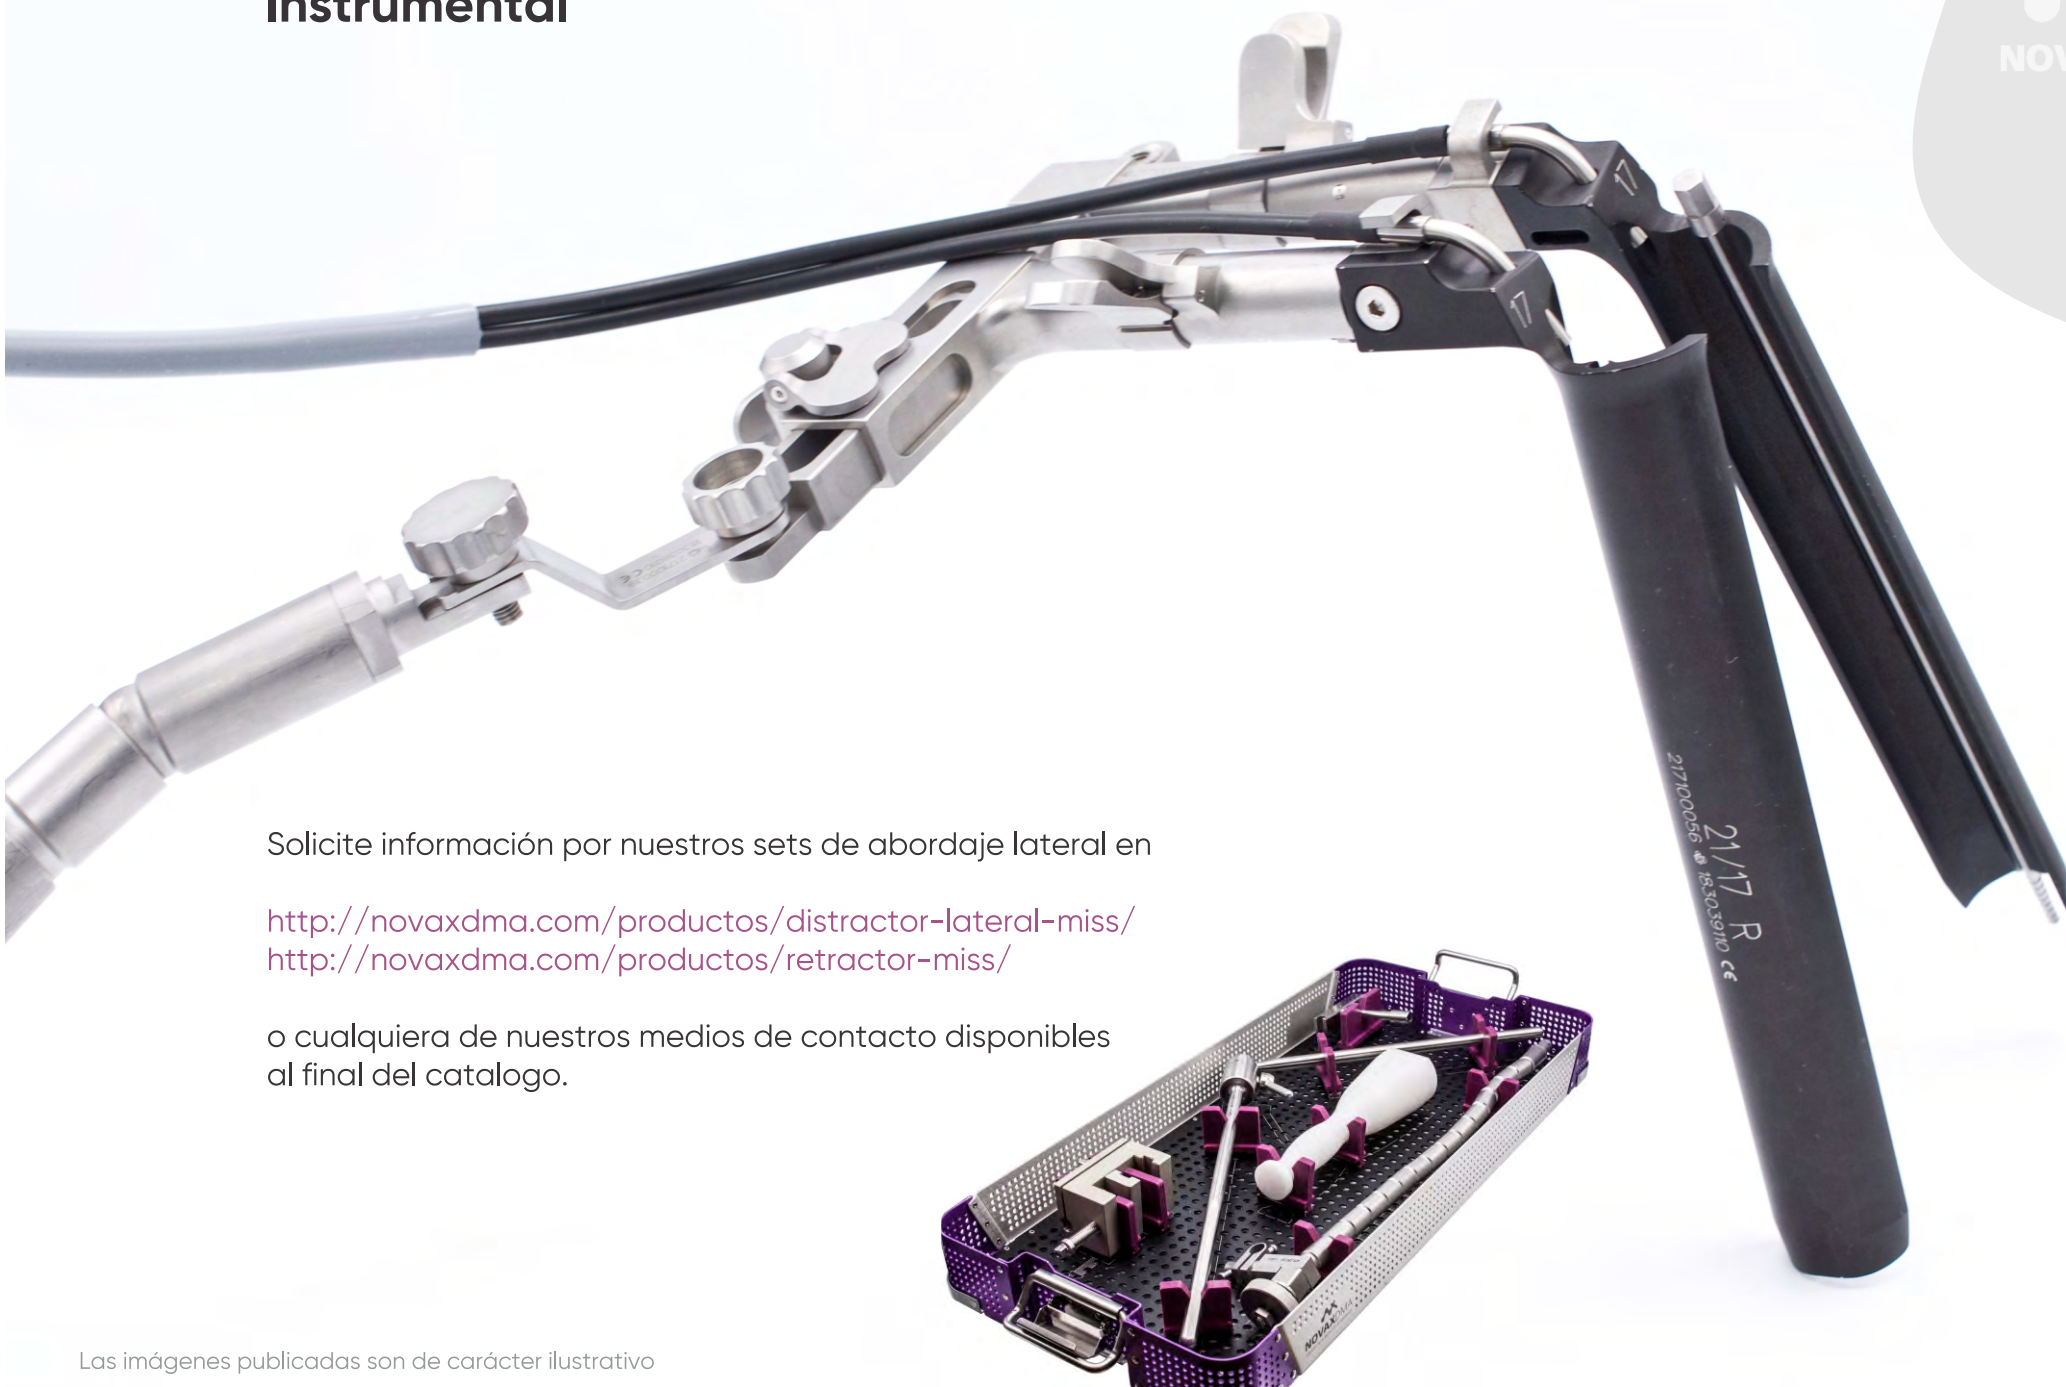

Solicite información por nuestros sets de abordaje lateral en

<http://novaxdma.com/productos/distractor-lateral-miss/>

<http://novaxdma.com/productos/retractor-miss/>

o cualquiera de nuestros medios de contacto disponibles al final del catalogo.



COLUMNA

SILUETE

Celda de fusión intersomática
dorsal y lumbar

Rev.G
Noviembre 2020



Contactate con nosotros

Manuel Fraga 923 - C1427BTS - 54 11 4554 6430/1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA
www.novaxdma.com

Autorizado por la ANMAT: **PM1621-15**
El sistema de gestión de la calidad de
NOVAX DMA ha sido certificado según
la norma **ISO 13485:2016**

La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en **www.novaxdma.com**