



TRAUMA

INMEDICA®

Tornillos para fragmentos Pequeños

Tornillo doble rosca autocompresivo \varnothing 2.2



NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MÉDICOS AVANZADOS

Contenido

- 3 Tornillo doble rosca (autocompresivo) \varnothing 2.2 (sin cánula)
- 4 Instrumental
- 5 Contacto



Componentes

Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$

BK2-4-9	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 9mm de largo. LR: 4mm
BK2-4-10	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 10mm de largo. LR: 4mm
BK2-4-11	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 11mm de largo. LR: 4mm
BK2-4-12	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 12mm de largo. LR: 4mm
BK2-4-13	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 13mm de largo. LR: 4mm
BK2-4-14	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 14mm de largo. LR: 4mm
BK2-4-15	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 15mm de largo. LR: 4mm
BK2-5-16	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 16mm de largo. LR: 5mm
BK2-5-17	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 17mm de largo. LR: 5mm
BK2-5-18	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 18mm de largo. LR: 5mm
BK2-5-19	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 19mm de largo. LR: 5mm
BK2-6-20	Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ de 20mm de largo. LR: 6mm

Sin cánula

2.2




1.5




Instrumental

Instrumental para Tornillo doble rosca (autocompresivo) $\varnothing 2.2$ Para pequeños fragmentos

309 008 49 Atornillador BK2

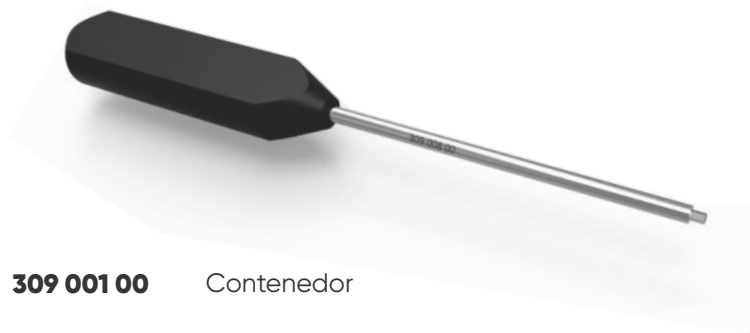

309 001 00 Contenedor

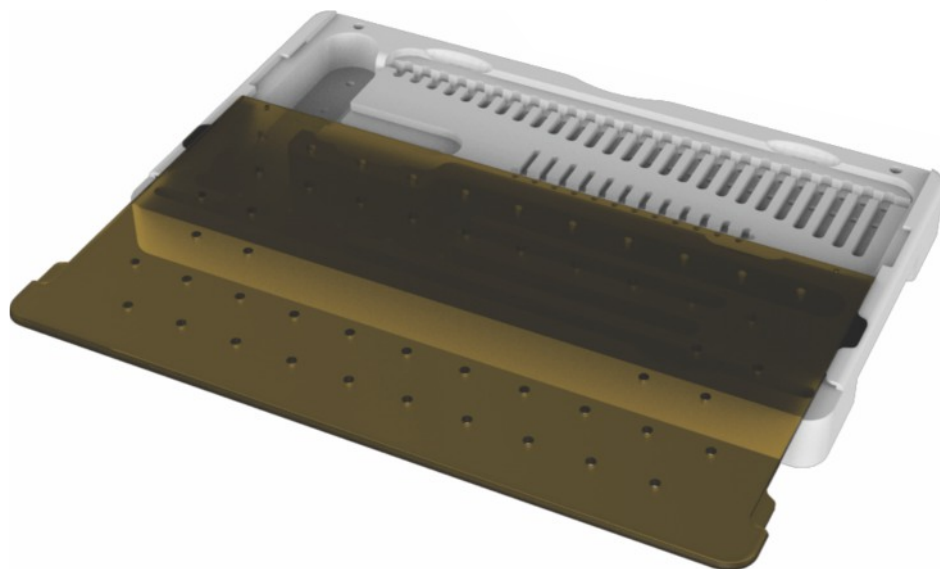

000 089 09 Clavija diam 1x250
3 unidades




240 036 00 Medidor de profundidad



060 015 29 Mecha diam 1.1 x 20 mm fresa



270 006 34 Pinza toma tornillos

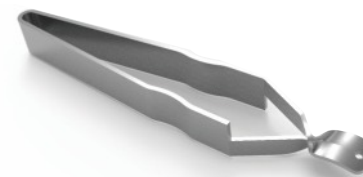

309 108 06 Levanta tornillo para Bk2





TRAUMA

INMEDICA®

Tornillos para fragmentos Pequeños

Tornillo doble rosca autocompresivo \varnothing 2.2

RevE
Agosto 2023



Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias
Directora técnica NO ESTÉRILES: Bioing. Vanina Croce - MN: 5699

Contactate con nosotros

Manuel Fraga 923 - C1427BTS - 54 11 4554 6430/1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA
www.novaxdma.com

Autorizado por la ANMAT: **PM1621-17**
El sistema de gestión de la calidad de
NOVAX DMA ha sido certificado según
la norma **IRAM-ISO 13485:2019**

La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en www.novaxdma.com