NOVAX
Sistema de placas para osteosíntesis

# Muñeca

## Placas autobloqueadas

### multidireccionales dobles estrechas

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

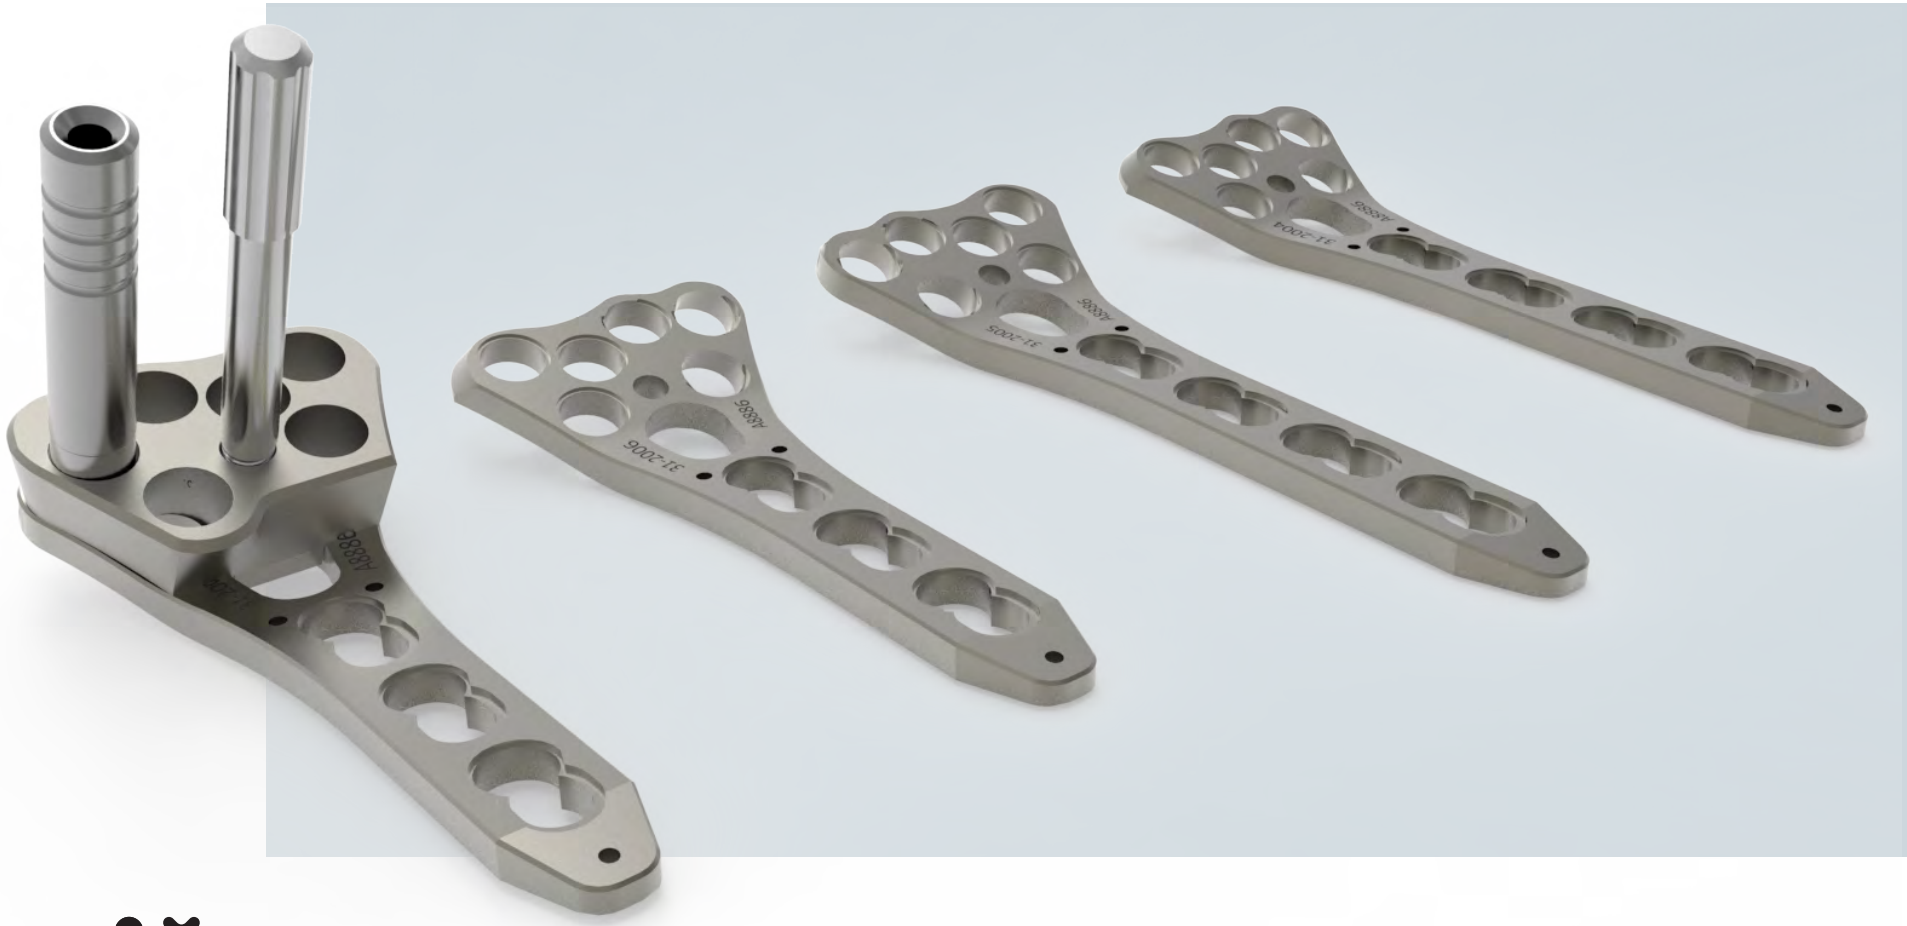

NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MEDICOS AVANZADOS

**www.novaxdma.com**
Manuel Fraga 923 - C1427BTS - 54 11 4554 6430/1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA
**PM 1621-27**

**Rev.J**
**Septiembre 2018**
La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en **www.novaxdma.com**

# Indice

Pág 3. Implantes

Pág 6. Instrumental

Pág 12. Técnica Quirúrgica

**Rev.J**
**Septiembre 2018**
La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en **www.novaxdma.com**

# Implantes

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

- **31-2006** Placa autobloqueada multidireccional muñeca doble corta estrecha DERECHA

- **31-2007** Placa autobloqueada multidireccional muñeca doble corta estrecha IZQUIERDA

- **31-2004** Placa autobloqueada multidireccional muñeca doble larga estrecha DERECHA

- **31-2005** Placa autobloqueada multidireccional muñeca doble larga estrecha IZQUIERDA

Cotas generales

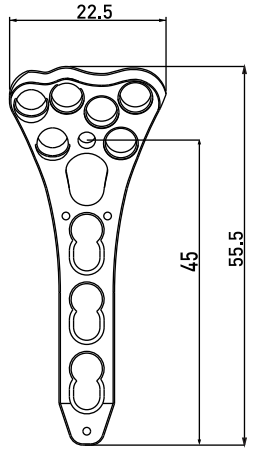


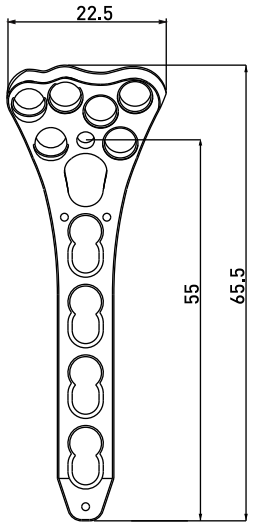


**Rev.J**
**Septiembre 2018**
La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en **www.novaxdma.com**

# Implantes

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

## Tornillos ø2.7

| | |
|---|---|
| P27-0008 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 8 mm |
| P27-0010 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 10 mm |
| P27-0012 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 12 mm |
| P27-0014 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 14 mm |
| P27-0016 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 16 mm |
| P27-0018 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 18 mm |
| P27-0020 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 20 mm |
| P27-0022 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 22 mm |
| P27-0024 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 24 mm |
| P27-0026 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 26 mm |
| P27-0028 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 28 mm |
| P27-0030 | Tornillo p/placa diam 2.7 x 30 mm |

## Tornillos bloqueados ø2.7

| | |
|---|---|
| DR1-27-08 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 8 mm |
| DR1-27-10 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 10 mm |
| DR1-27-12 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 12 mm |
| DR1-27-14 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 14 mm |
| DR1-27-16 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 16 mm |
| DR1-27-18 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 18 mm |
| DR1-27-20 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 20 mm |
| DR1-27-22 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 22 mm |
| DR1-27-24 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 24 mm |
| DR1-27-26 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 26 mm |
| DR1-27-28 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 28 mm |
| DR1-27-30 | Tornillo doble rosca ø2.7 x 30 mm |

# Implantes

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

- TE-02-08 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x8mm
- TE-02-10 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x10mm
- TE-02-12 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x12mm
- TE-02-14 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x14mm
- TE-02-16 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x16mm
- TE-02-18 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x18mm
- TE-02-20 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x20mm
- TE-02-22 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x22mm
- TE-02-24 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x24mm
- TE-02-26 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x26mm
- TE-02-28 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x28mm
- TE-02-30 Tornillo vástago de expansión hex diam 2x30mm

NOVAXDMA

# Instrumental

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

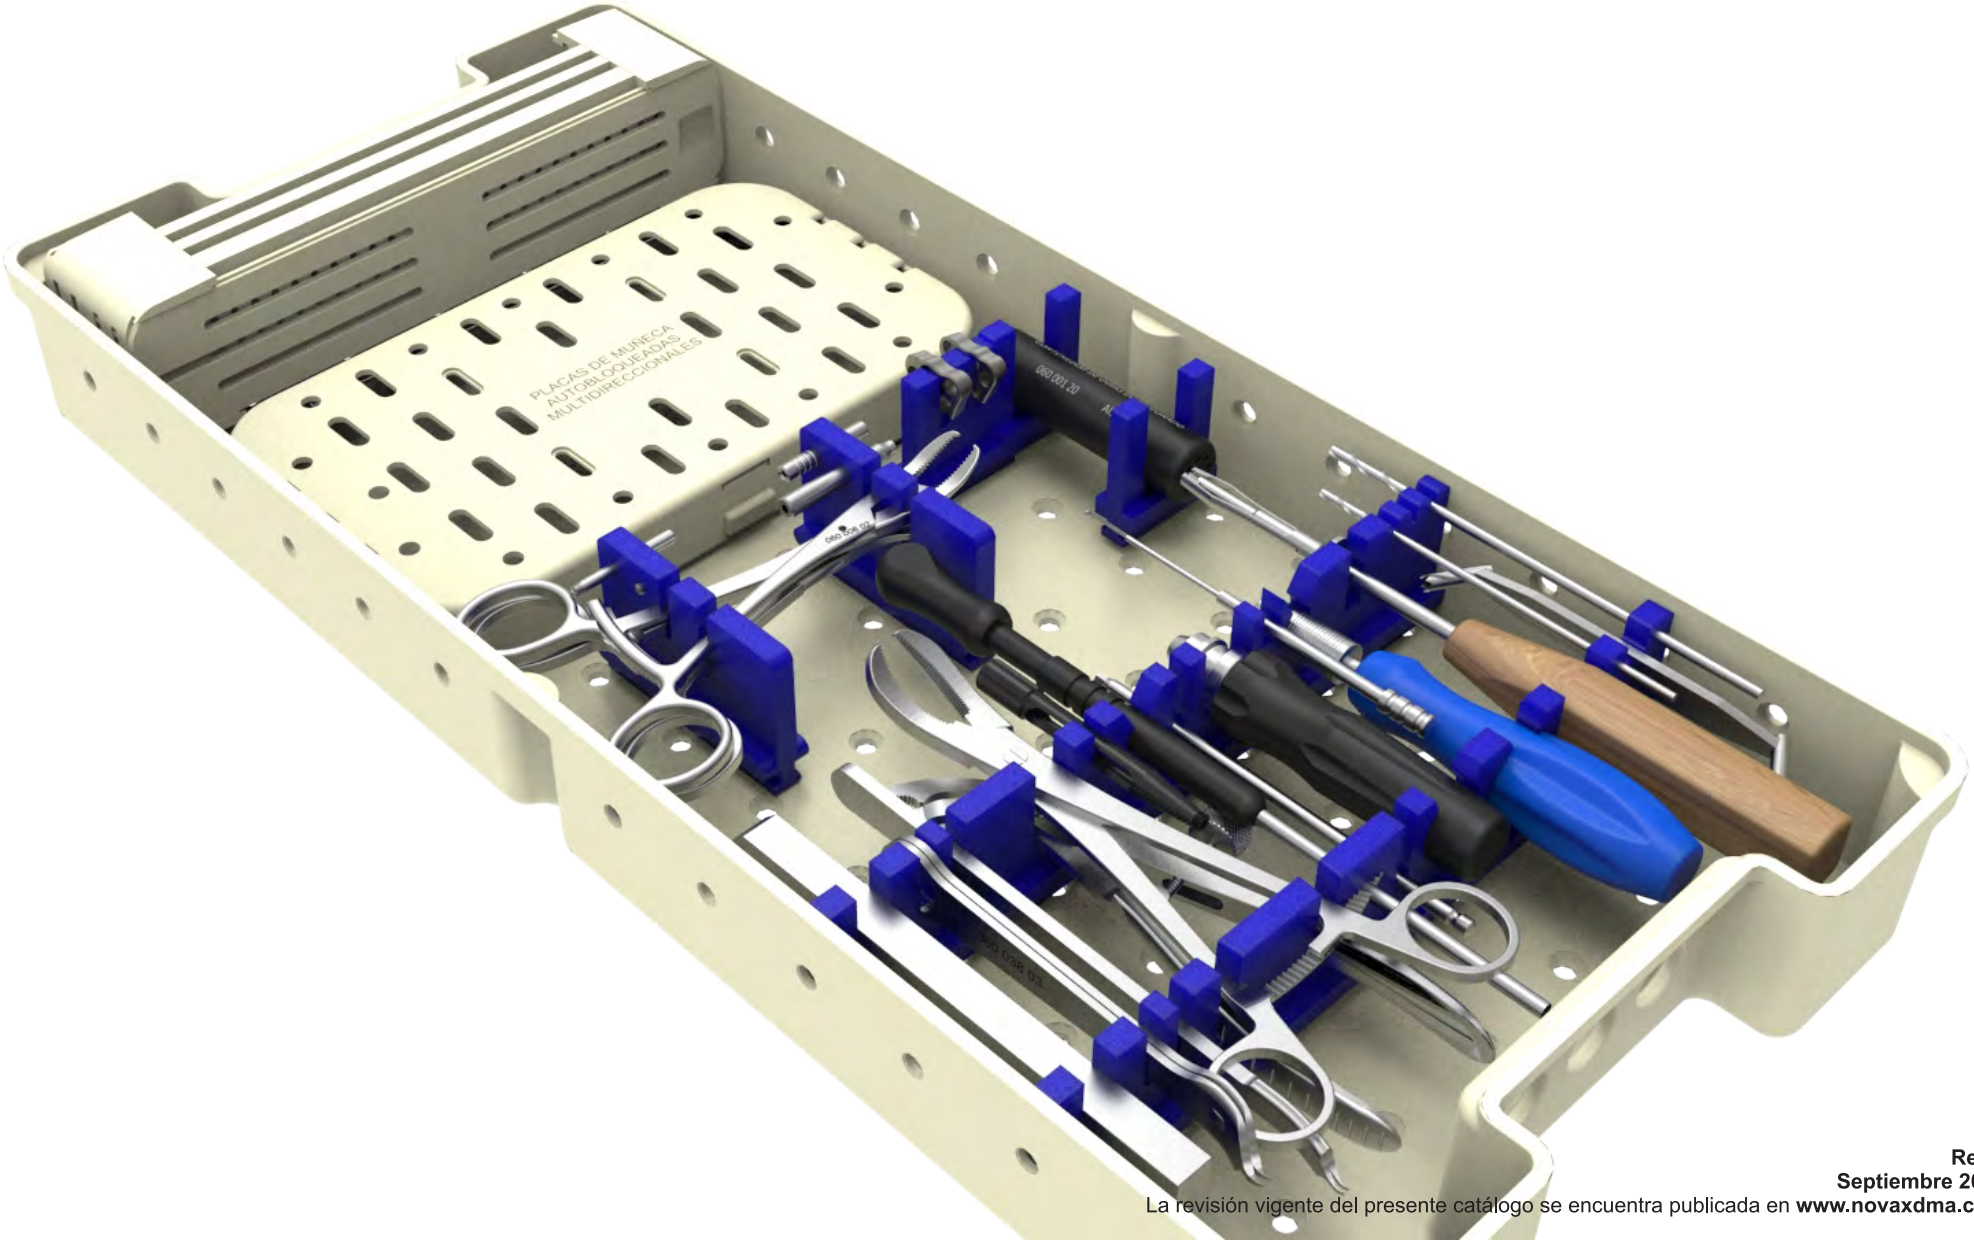


**Rev.J**
**Septiembre 2018**
La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en **www.novaxdma.com**

# Instrumental

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

| | | |
|---|---|---|
| • 060 018 75 | Guía de perforado para placa de muñeca | |
| • 060 099 01/02 | Plantilla para placa de muñeca izq y der | |
| • 060 107 06 | Tornillo de fijación para placa de muñeca | |
| • 060 107 07 | Tornillo de fijación corto para placa de muñeca | |
| • 301 018 67 | Guía de perforado larga | |
| • 301 018 39 | Guía de perforado descartable M4,5 | |

# Instrumental

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

- **060 006 03** Pinza de reducción grande dentada autocentrante (170 mm)

- **060 017 00** Grifa

- **060 038 02** Separadores de Hohmann 8x160mm

- **060 038 03** Separadores de Hohmann 15x120mm

- **060 006 02** Pinza de reducción chica dentada a cremallera (140mm)

- **060 006 11** Pinza de sujeción para placa

# Instrumental

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

- 270 008 29 — Atornillador hex 2,5 mango de madera c/ toma tornillo

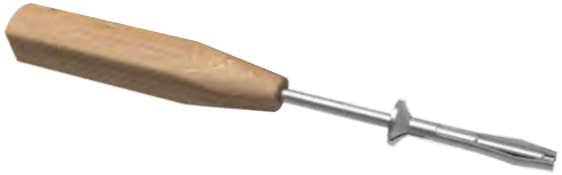

- 060 006 01 — Pinza de verbrugge autocentrante sujeción hueso (150 mm)

- 060 036 04 — Medidor de profundidad canulado sin rosca
- 060 010 06 — Varilla para medidor de profundidad

- 060 012 00 — Mango para atornillador con acople rápido SILICONA O ACETAL

- 060 018 07 — Guía de mecha ø2 y ø2,7

# Instrumental

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

- **060 008 02** Atornillador hex. 2,5 largo para acople rápido
- **060 015 10** Mecha ø2,7
- **060 015 01** Mecha ø2x100mm
- **060 036 07** Medidor de profundidad varilla incorporada
- **060 025 14** Torquímetro Inox 4lb
- **060 001 20** Contenedor de guías de perforado

# Instrumental

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

- 060 110 23 Tornillera ø2,7

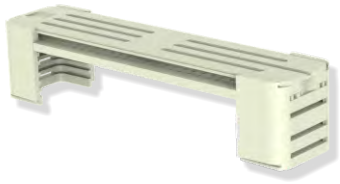

- 060 002 64 Contenedor de placas

- 060 001 00 Bandeja de instrumental

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

# MUÑECA

## Placa autobloqueada
### multidireccional doble estrecha

## Técnica Quirúrgica

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

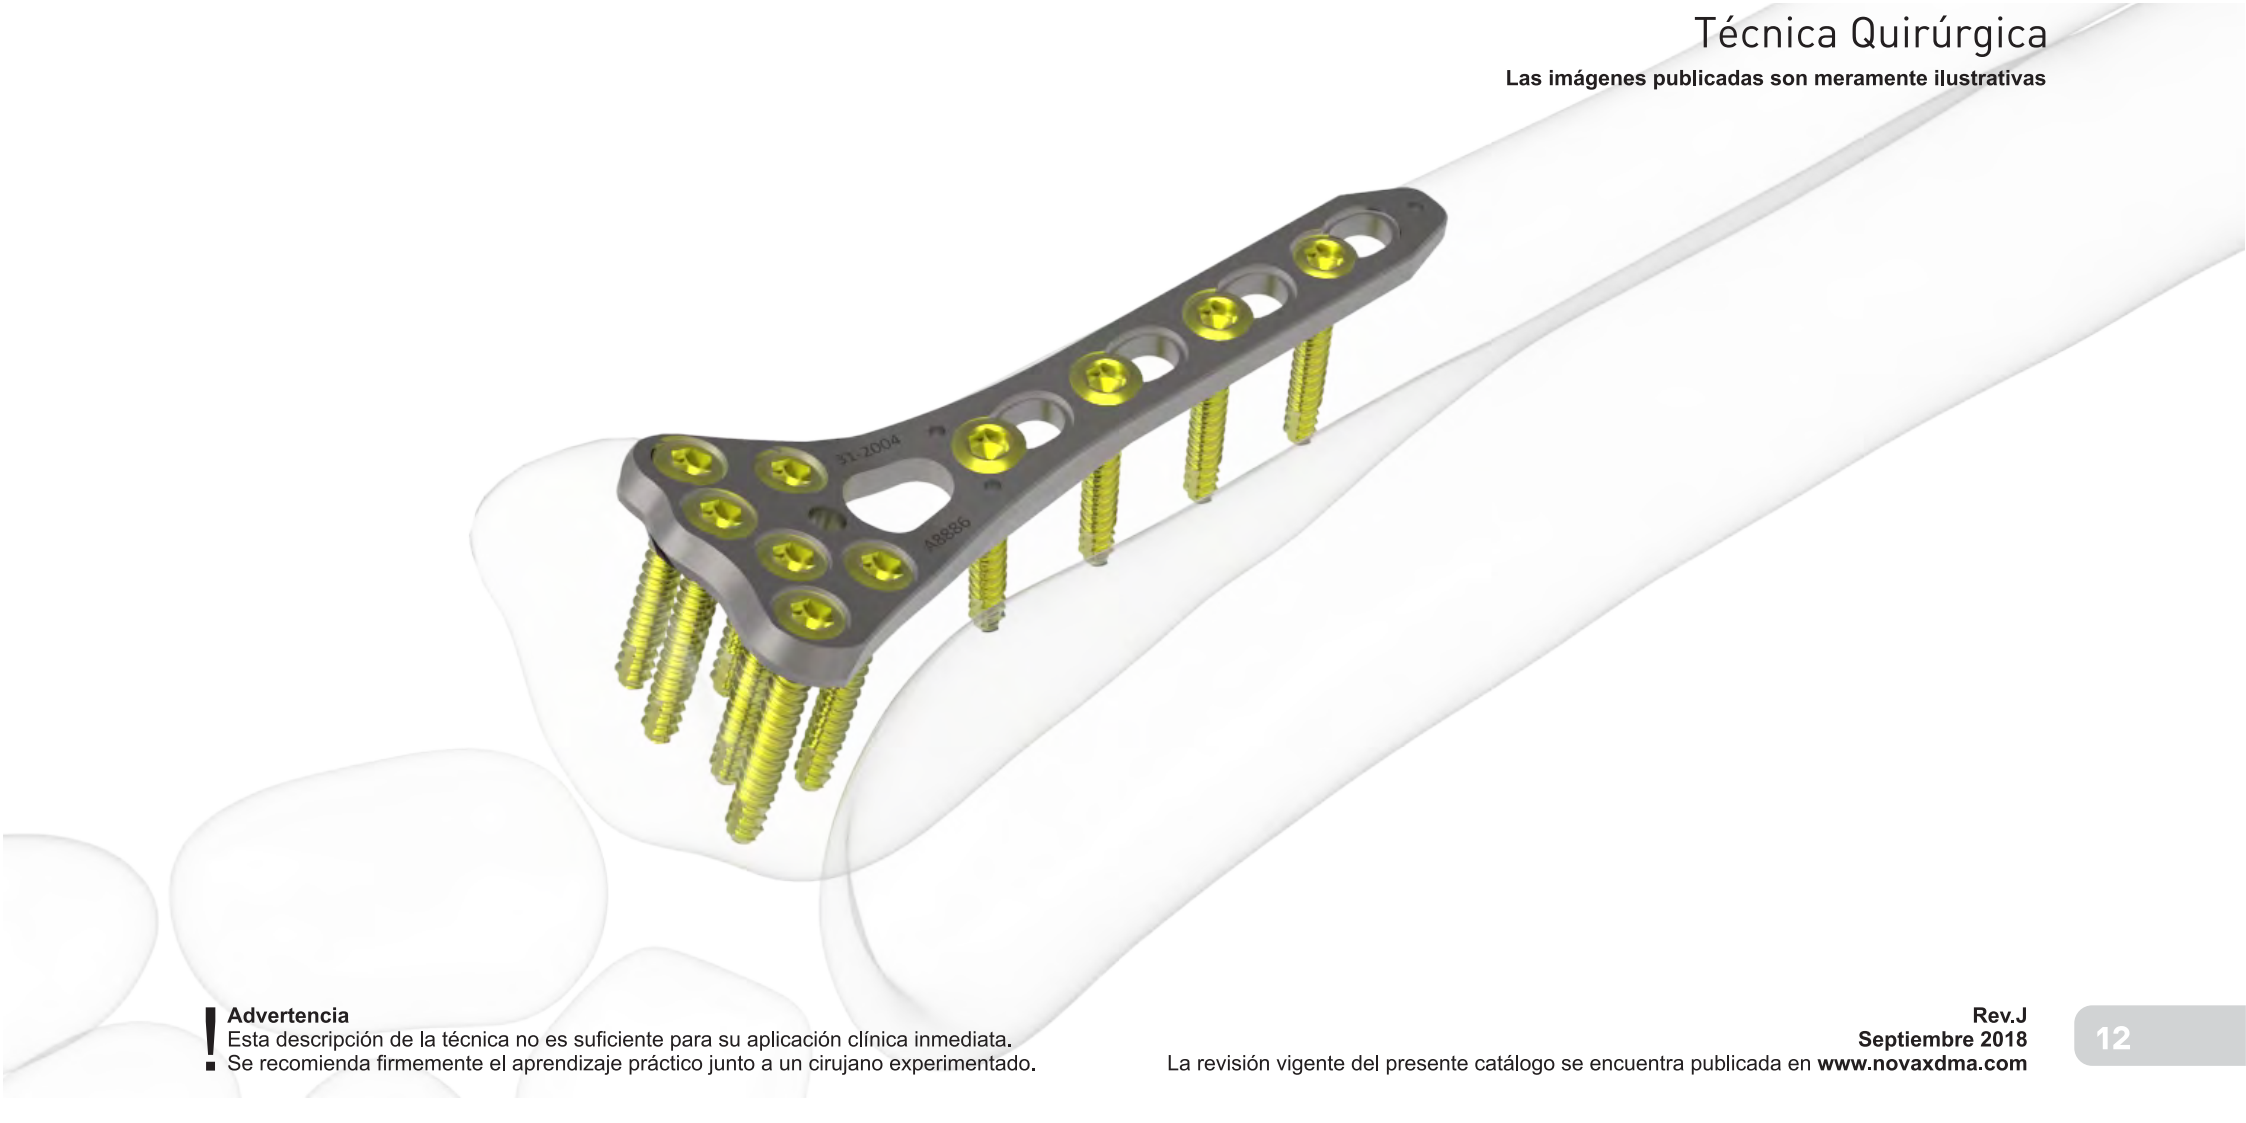


**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

**Rev.J**
**Septiembre 2018**
La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en **www.novaxdma.com**

# Opción 1
## Sin plantilla de perforado

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

1

**Pinza de reducción chica dentada a cremallera**
**140 mm**
**060 006 02**

2

**Clavija**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

# Opción 1

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

NOVAXDMA

## 3

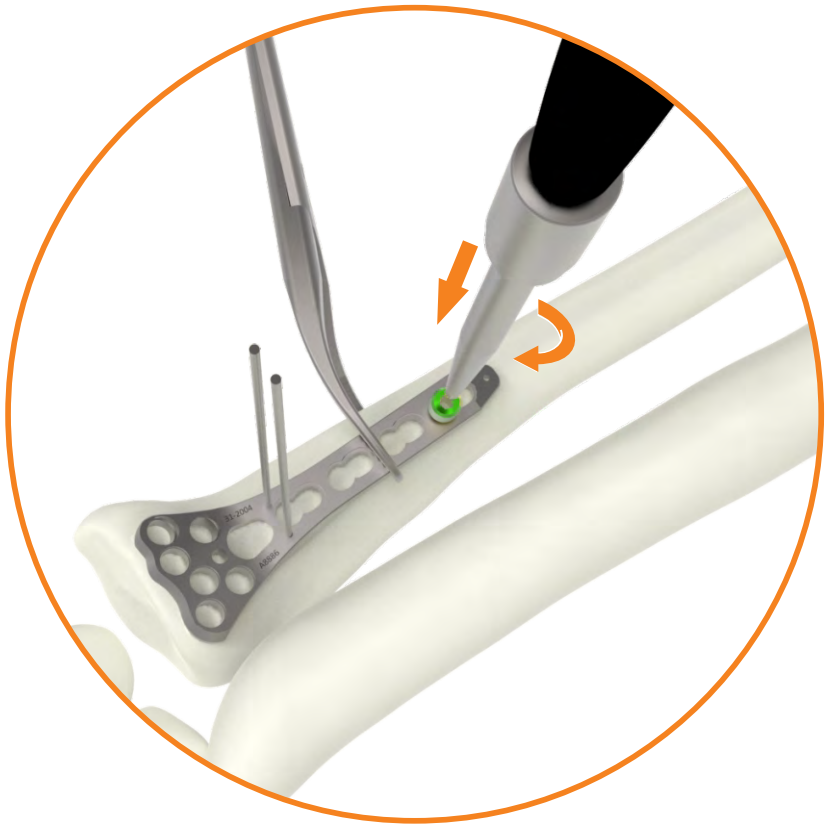

**Mango para atornillador con acople rápido**
**060 012 00**

**Atornillador hex. 2,5 largo AO**
**060 008 02**

## 4

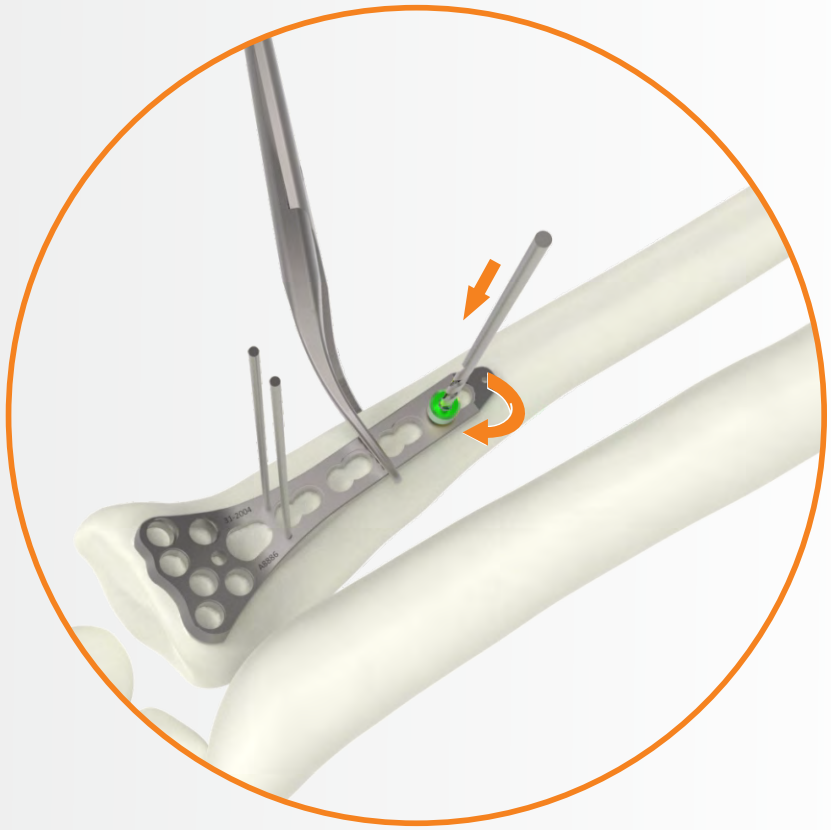

**Guía de perforado M4,5**
**301 018 39**

**Mecha ø2x100 mm**
**060 015 01**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

# Opción 1

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

NOVAXDMA

## 5 Medidor de profundidad sin rosca

**Medidor de profundidad sin rosca**
**000 036 04**

**Varilla para medidor de profundidad**
**060 010 06**

ó

## Medidor de profundidad con varilla incorporada

**Guía de perforado M4,5**
**301 018 39**

**Medidor de profundidad varilla incorporada**
**060 036 07**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

# Opción 1

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

NOVAXDMA

## 5

**Atornillador hex 2,5 mango de madera**
**c/ toma tornillo**
**270 008 29**

## 6

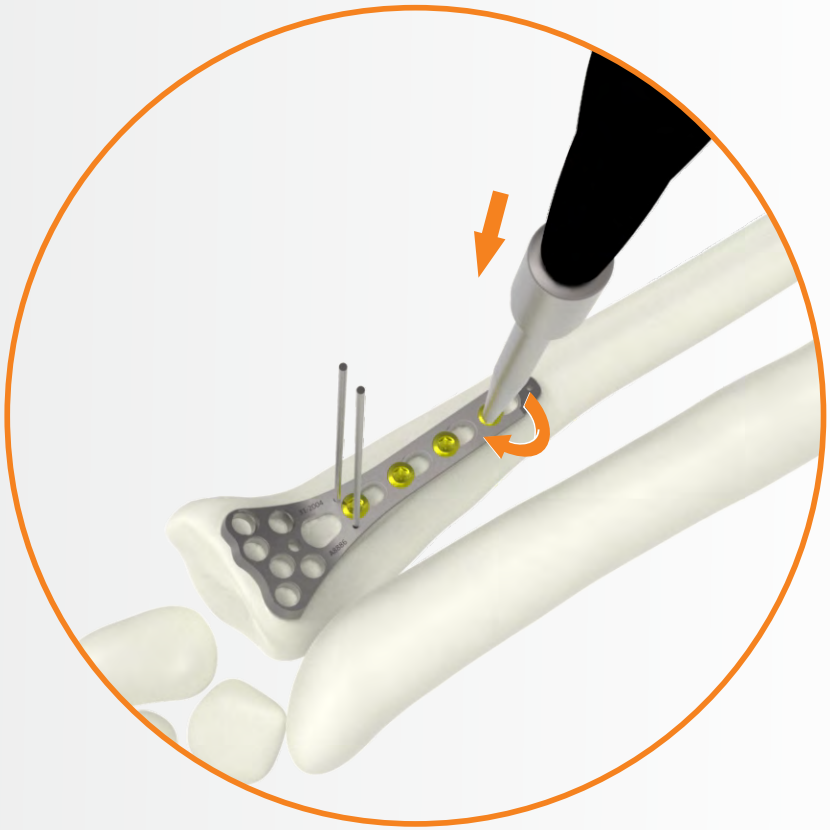

**Mango para atornillador**
**con acople rápido**
**060 012 00**

**Atornillador hex. 2,5 largo AO**
**060 008 02**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

# Opción 1

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

NOVAXDMA

## 7

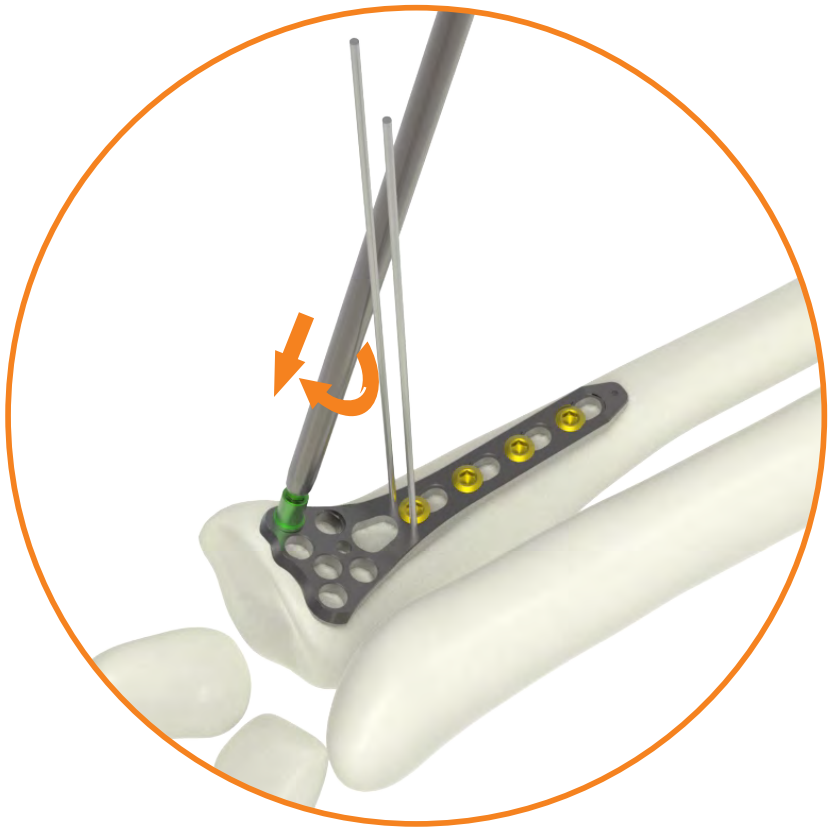

## 8

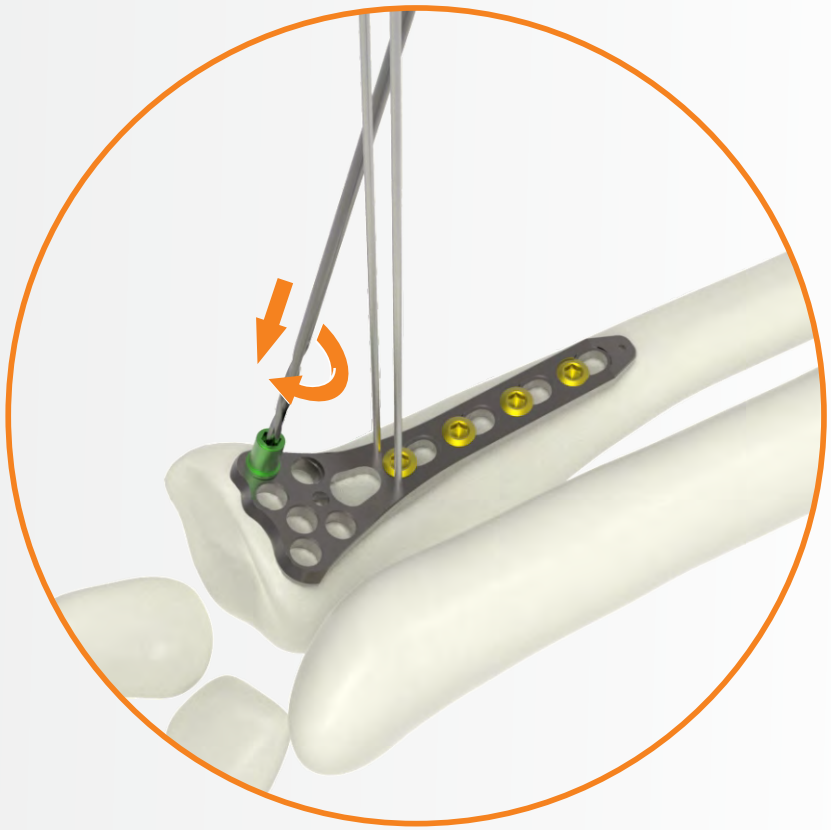

**Mango para atornillador con acople rápido**
**060 012 00**

**Guía de perforado M4,5**
**301 018 39**

**Atornillador hex. 2,5 largo AO**
**060 008 02**

**Mecha 2x100 mm**
**060 015 01**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

# Opción 1

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

## 9

**Medidor de profundidad**
**sin rosca**
**000 036 04**

**Varilla para medidor de profundidad**
**060 010 06**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

NOVAXDMA

## 10

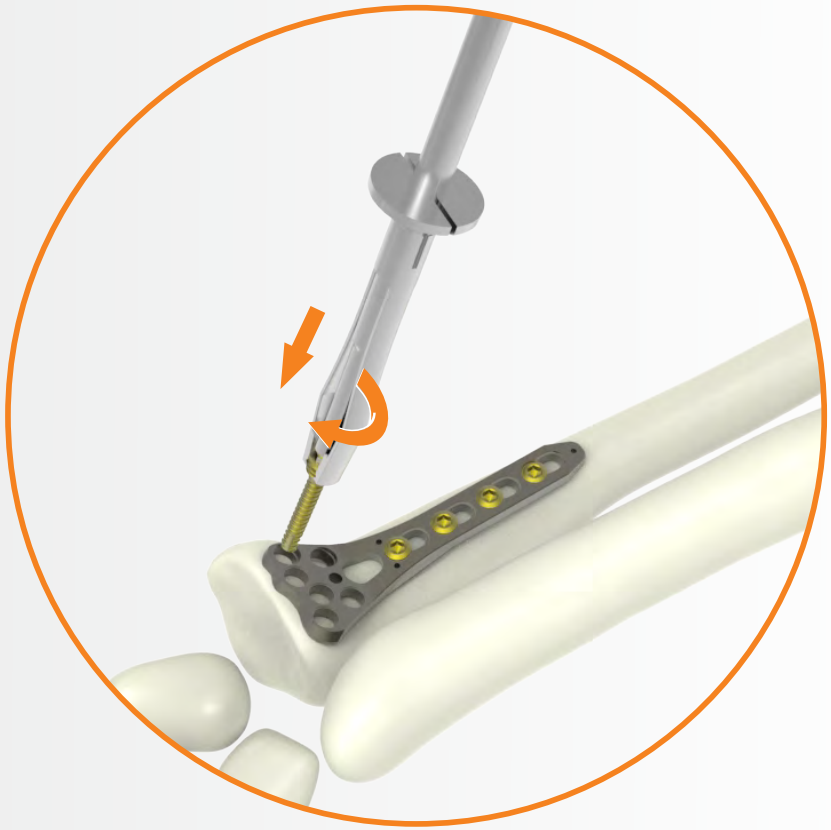

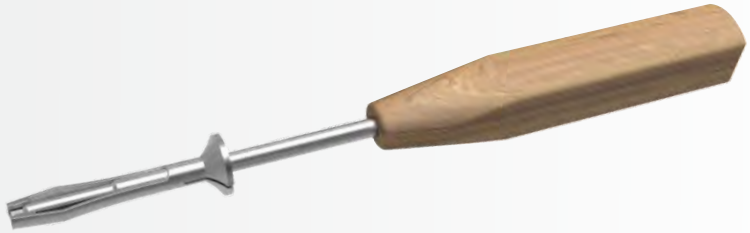

**Atornillador hex 2,5 mango de madera**
**c/ toma tornillo**
**270 008 29**

# Opción 1

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

## 11

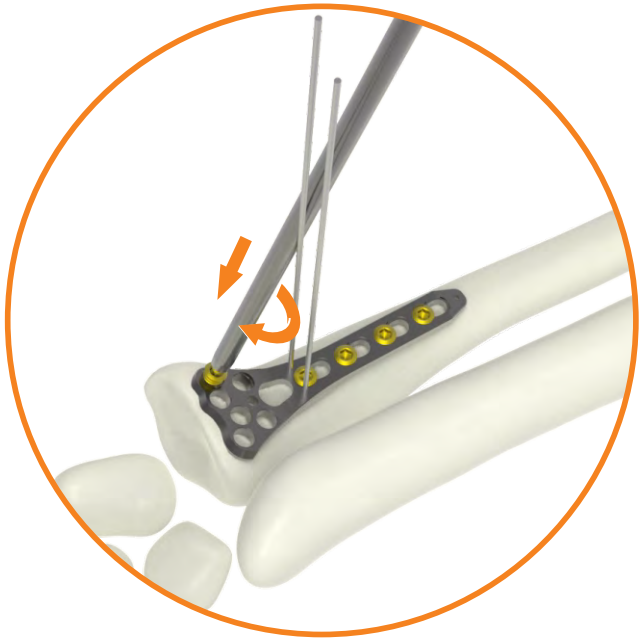

**Atornillador hex. 2,5 largo AO**
**060 008 02**

**Mango para atornillador**
**con acople rápido**
**060 012 00**

**Torquímetro Inox 4lb**
**060 025 14**

+

**Atornillador hex. 2,5 largo AO**
**060 008 02**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

# Opción 2

## Con plantilla de perforado

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

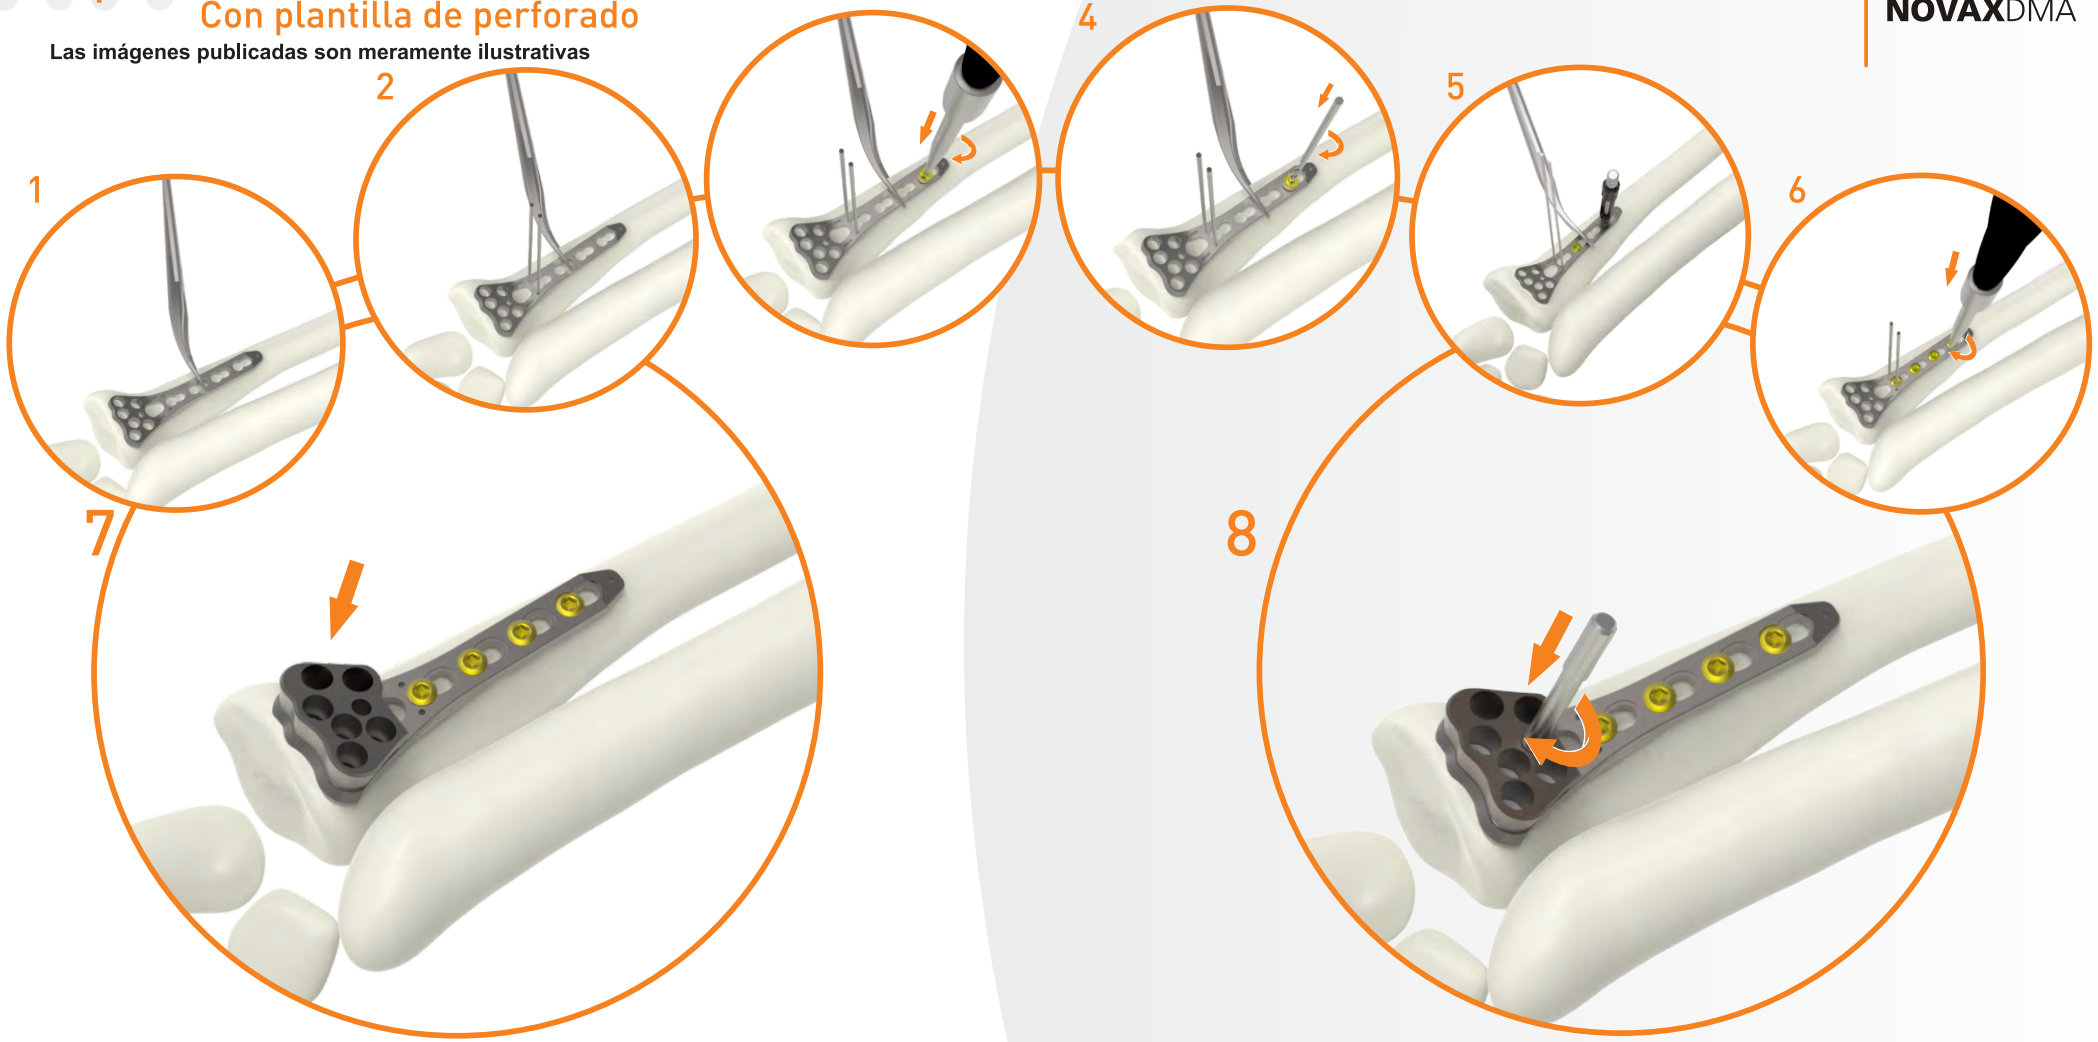

**Plantilla de perforado (derecha) para Placa de muñeca 31-2004**
**060 099 01**

**Tornillo de fijación para placa de muñeca 31**
**060 107 06**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

# Opción 2

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

## 9 A - Con tornillo largo

**Tornillo de fijación para placa de muñeca 31**
**060 107 06**

**Guía de perforado para placa de muñeca**
**060 018 75**

## 10

**Mecha 2x100 mm**
**060 015 01**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

# Opción 2

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

## 9 B-Con tornillo corto

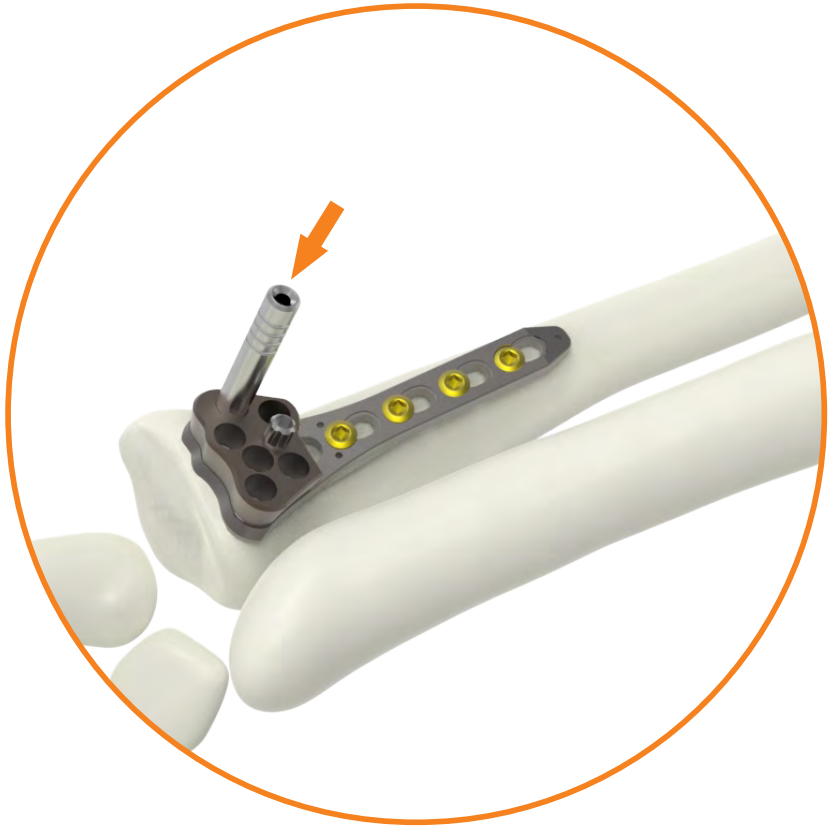

**Tornillo corto de fijación para placa de muñeca 31**
**060 107 07**

**Guía de perforado para placa de muñeca**
**060 018 75**

## 10

**Mecha 2x100 mm**
**060 015 01**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

# Opción 2

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

## 11 A - Con tornillo largo

**Medidor de profundidad**
**varilla incorporada**
**060 036 07**

**Varilla para medidor de profundidad**
**060 010 06**

**Medidor de profundidad canulado**
**sin rosca**
**060 036 04**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

## 12

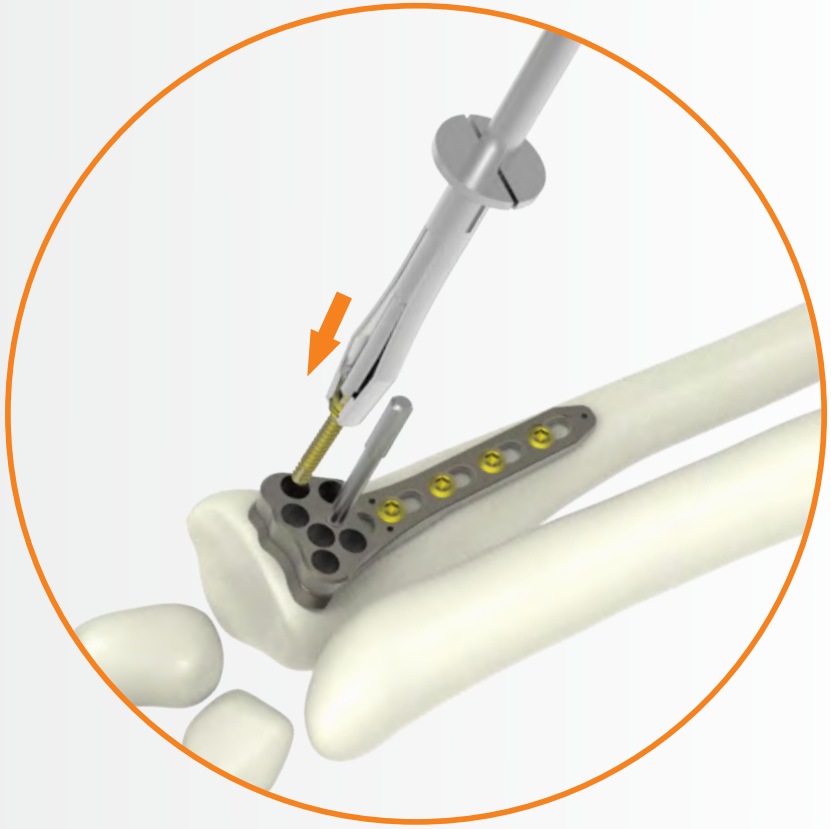

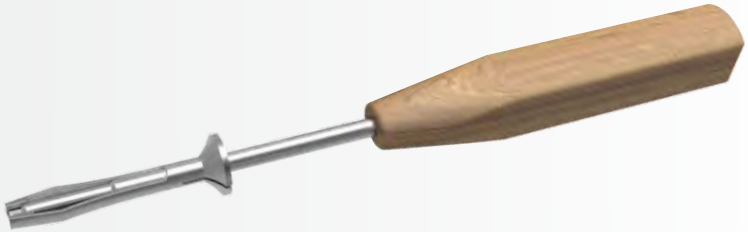

**Atornillador hex 2,5 mango de madera**
**c/ toma tornillo**
**270 008 29**

# Opción 2

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

## 13

**Atornillador hex. 2,5 largo con acople rápido**
**060 008 02**

**Mango para atornillador**
**con acople rápido**
**060 012 00**

**Torquímetro Inox 4lb**
**060 025 14**
**(Cant.1)**

+

**Atornillador hex. 2,5 largo AO**
**060 008 02**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

# Tornillos

**Tornillo doble rosca ø2.7**
DR1-27-08/30

**Tornillo para placa de pie ø2.7**
P27-0008/0030

**Tornillo vástago de expansión hex ø2.0**
TE-02-08/30

# Placas

31-2005
izq.

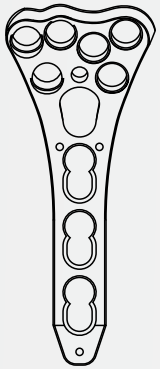

31-2006
Der.

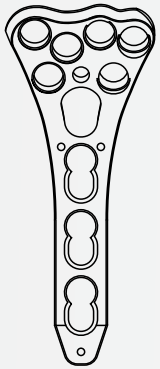

31-2007
izq.

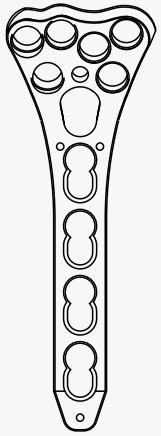

31-2004
Der.

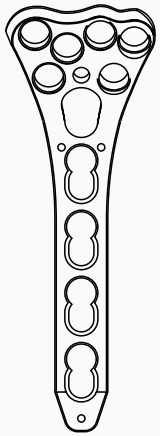

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

**Advertencia**
Esta descripción de la técnica no es suficiente para su aplicación clínica inmediata.
Se recomienda firmemente el aprendizaje práctico junto a un cirujano experimentado.

Pinza de reducción Grande dentada autocentrante
(170 mm)
060 006 06
(Cant. 1)

Pinza de verbrugge autocentrante sujeción hueso (150mm)
060 006 01
(Cant.1)

Medidor de profundidad
sin rosca
000 036 04
(Cant.1)

Atornillador hex. 2,5 largo AO
060 008 02
(Cant.1)



ó

Mango para atornillador con acople rápido
060 012 00
(Cant.1)

Atornillador hex 2,5 mango de madera c/ toma tornillo
270 008 29
(Cant.1)

Grifa
060 017 00
(Cant. 2)

Separadores de Hohmann
8x160 mm
060 038 02
(Cant. 2)

Separadores de Hohmann
15x120 mm
060 038 03
(Cant. 2)

Pinza de reducción chica dentada a cremallera
(140 mm)
060 006 02
(Cant. 1)



Pinza de sujeción para placa
060 006 11
(Cant. 1)

Plantilla de perforado
(derecha y izquierda)
para Placa de muñeca 31-2004
060 099 01/02

Guía de perforado larga
301 018 67

Guía de perforado
para placa de muñeca
060 018 75

Tornillo CORTO fijación plantilla de perforado
060 107 07

Tornillo LARGO fijación plantilla de perforado
060 107 06

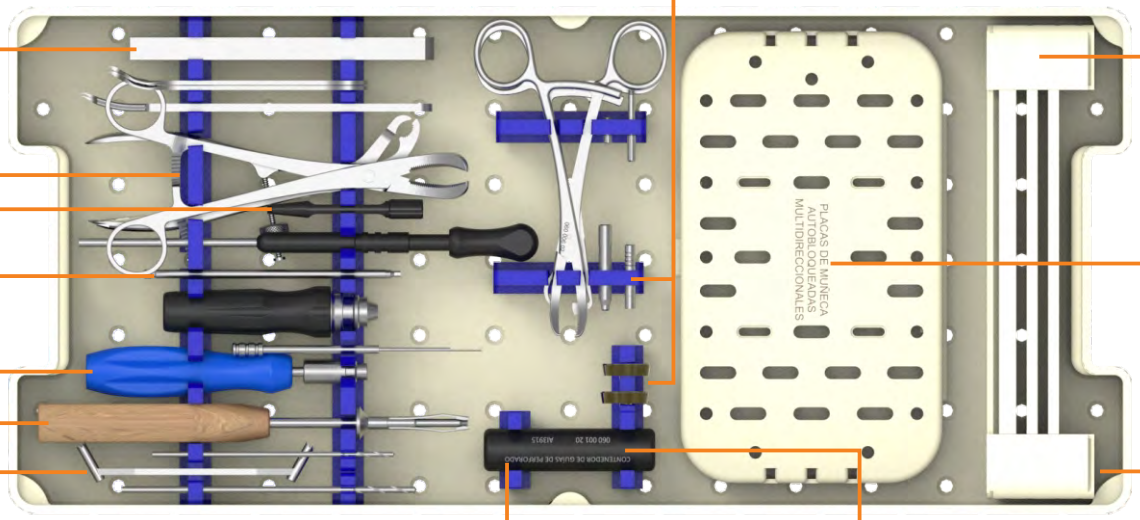

Tornillera ø2.7
060 110 23
(Cant. 1)

Contenedor de placas
060 002 64
(Cant.1)

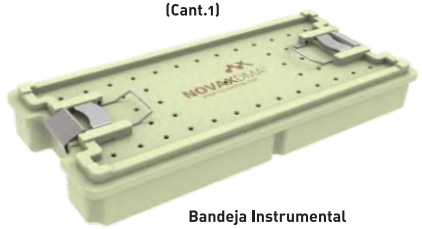

Bandeja Instrumental
060 001 00
(Cant.1)

Contenedor de guías de perforado
060 001 20
(Cant.1)

Guía de perforado M4,5
301 018 39
(Cant.5)

Guía de mecha
060 018 07
ø2 y ø2,7
(Cant.1)

Varilla para medidor de profundidad
060 010 06
(Cant.1)

Mecha ø2,7 mm
060 015 10
(Cant.1)

Mecha ø2x100 mm
060 015 01
(Cant.1)

Medidor de profundidad varilla incorporada
060 036 07
(Cant.1)

Torquímetro Inox 4lb
060 025 14
(Cant.1)

**Las imágenes publicadas son meramente ilustrativas**

La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en **www.novaxdma.com**

Versión revisada Septiembre 2018
Publicado 11-09/18
27 páginas

**Habilitación ANMAT PM 1621-27**
El sistema de gestión de la calidad de **NOVAX DMA** ha sido certificado según la norma
**IRAM-ISO 13485:2005**

NOVAXDMA
DISPOSITIVOS MEDICOS AVANZADOS

**Novax DMA S.A.**
Manuel Fraga 923 - C1427BTS - 54 11 4554 6430/1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA
**www.novaxdma.com**

La revisión vigente del presente catálogo se encuentra publicada en **www.novaxdma.com**